


УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, МНОГОКАНАЛЬНОЕ

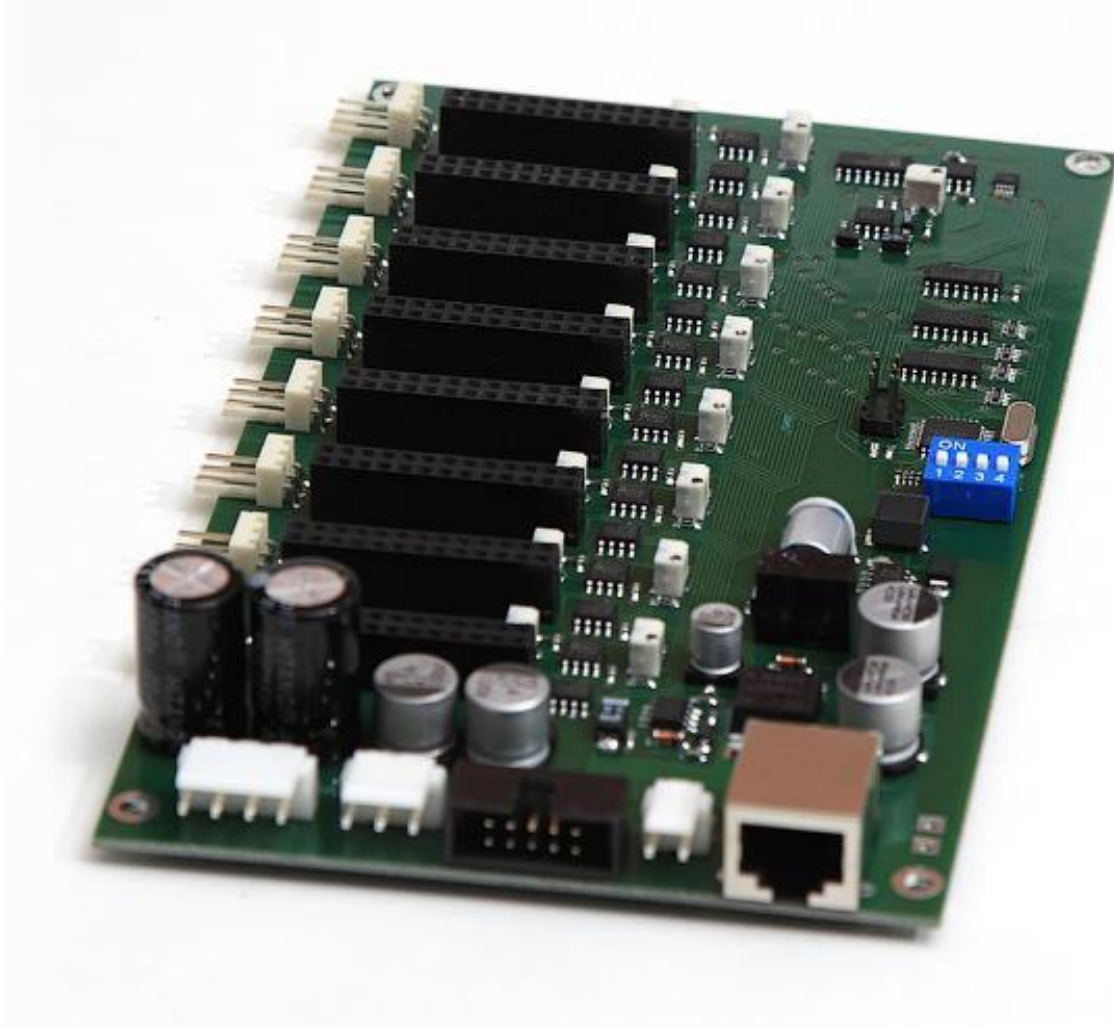

Формирует управляющее напряжение в диапазоне 0...10В.

Точность установки напряжения $\pm 0,003\%$.

Температурная нестабильность 15 ppm/С.

Уровень выходных шумов управляющего напряжения $<30\mu\text{В}$ в полосе сигнала 1 - 10Гц.

Точность измерения выходного напряжения $\pm 0,006\%$.